


Diplomarbeit

Methodenvergleich zwischen Recipe und Chromsystems Reagenzkit für Vitamin C Messung mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC)

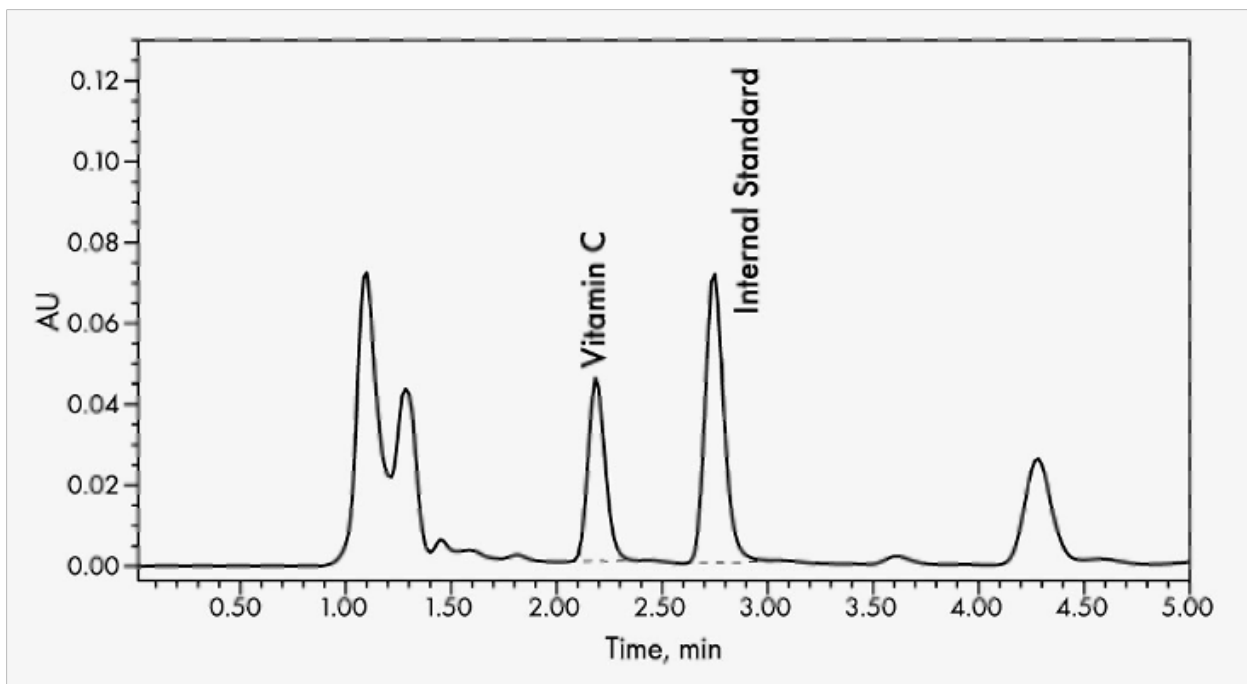

Luciana Rocha de Assis, BMA 18-21 A

Eingereicht an der Höheren Fachschule

medi | Zentrum für medizinische Bildung | Biomedizinische Analytik

Praktikumsbetrieb: MCL Medizinische Laboratorien AG Niederwangen

Bern, 04.06.2021